



### Informe de función pulmonar

#### Información del sujeto



ID:	75266859	ID alternativo:		
Apellidos:	Silva Zarate	Nombre:	Robinson	Segundo nombre:
Población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre	Fecha de nacimiento:
Edad:	21	Altura:	175 cm	Peso:
IMC:	24,5			75,0 kg

#### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	19/08/2023 09:40	Dispositivo:	Pneumotrac	Número de serie:	25392
Nº de pruebas:	7	Rev. de la exactitud:	17/08/2023 08:38	Usuario:	Administrador
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

#### Gráfico de flujo/volumen

#### Gráfico de volumen/tiempo

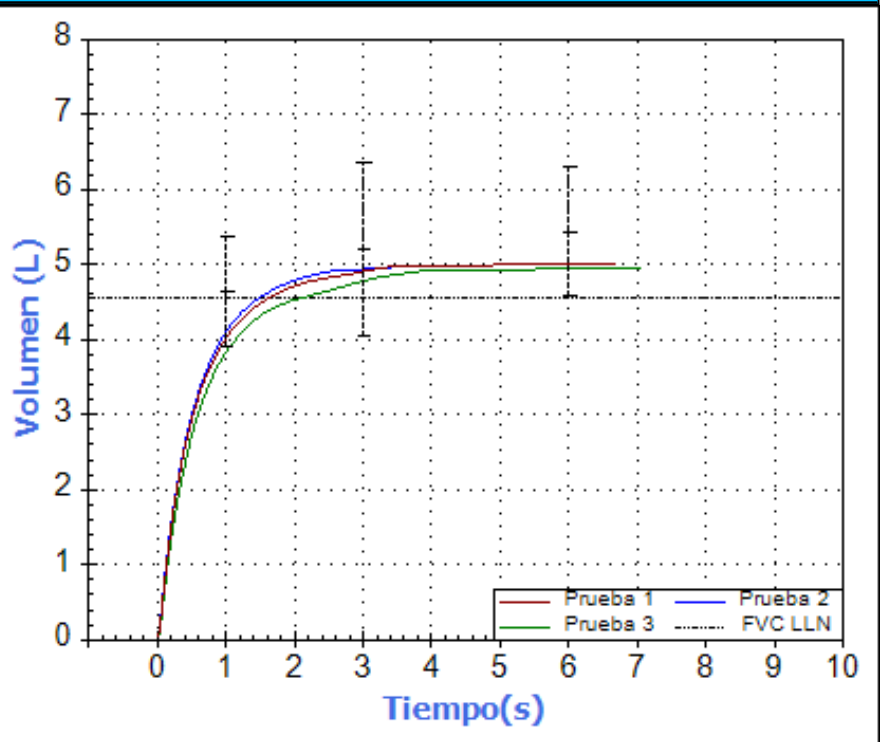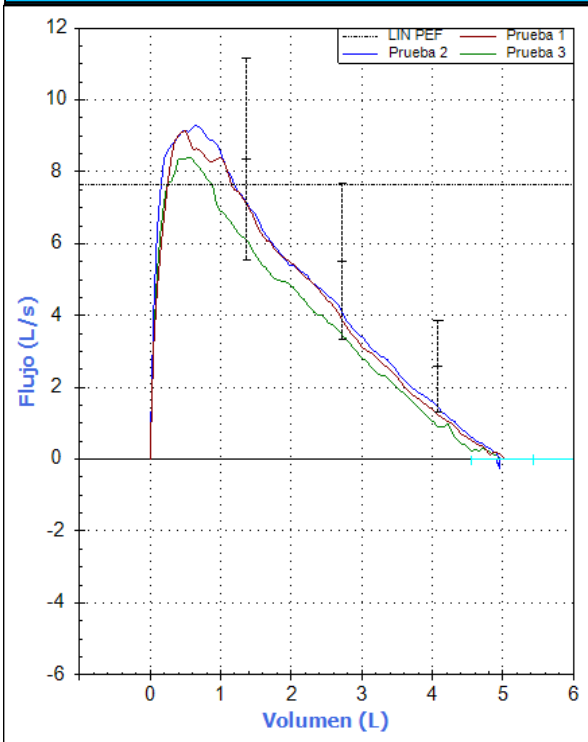

#### Resultados

Parámetro	Prev.	LLN	Mejor ATS/ERS	Porcentaje prev.	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3
FVC (L)	<b>5,43</b>	4,55	<b>5,02</b>	<b>92</b>	5,02	4,96	4,96
FEV1 (L)	<b>4,64</b>	3,90	<b>4,11</b>	<b>89</b>	4,03	4,11	3,85*
Relación de FEV1	<b>0,85</b>	0,76	<b>0,82</b>	<b>96</b>	0,80	0,83	0,78
FEV6 (L)	<b>5,44</b>	4,58	<b>4,96</b>	<b>91</b>	4,96	4,96	4,96
PEF (L/Min)	<b>612</b>	458	<b>558</b>	<b>91</b>	550	558	506
FEF25-75 (L/s)	<b>5,13</b>	3,46	<b>3,96</b>	<b>77</b>	3,70	3,96	3,32*

Valores en BTPS, \*Por debajo del límite inferior de normalidad (LLN)

#### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
B	0,06 L (1,2%)	0,08 L (1,9%)	0 soplo(s)	1 soplo(s)	0 soplo(s)

#### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.