



### Informe de función pulmonar

#### Información del sujeto



ID:	42300371	ID alternativo:			
Apellidos:	Montoya Salazar	Nombre:	Rainer	Segundo nombre:	
Población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre	Fecha de nacimiento:	29/03/1984
Edad:	39	Altura:	180 cm	Peso:	84,0 kg
IMC:	25,9				

#### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	22/09/2023 09:59	Dispositivo:	Pneumotrac	Número de serie:	25392
Nº de pruebas:	4	Rev. de la exactitud:	13/09/2023 11:51	Usuario:	Administrador
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

#### Gráfico de flujo/volumen

#### Gráfico de volumen/tiempo

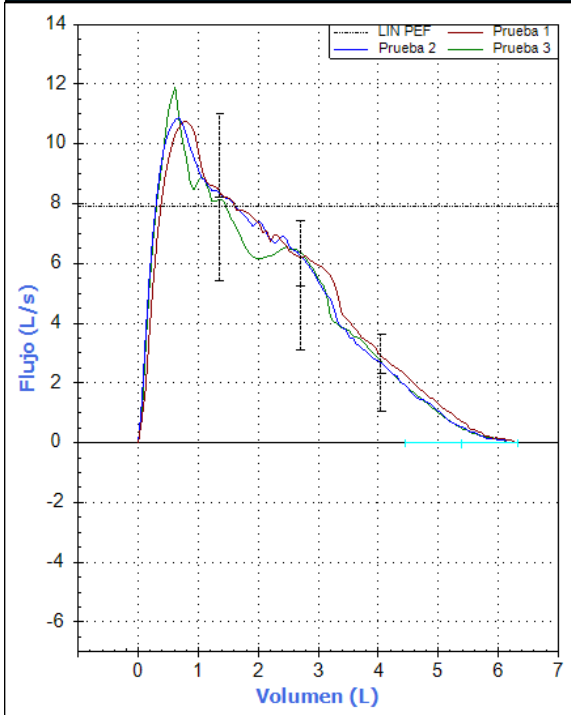

#### Resultados

Parámetro	Prev.	LLN	Mejor ATS/ERS	Porcentaje prev.	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3
FVC (L)	<b>5,39</b>	4,46	<b>6,29</b>	<b>117</b>	6,29	6,17	6,16
FEV1 (L)	<b>4,38</b>	3,59	<b>4,84</b>	<b>111</b>	4,84	4,70	4,69
Relación de FEV1	<b>0,82</b>	0,72	<b>0,77</b>	<b>94</b>	0,77	0,76	0,76
FEV6 (L)	<b>5,24</b>	4,33	<b>6,23</b>	<b>119</b>	6,23	6,10	6,13
PEF (L/Min)	<b>638</b>	475	<b>720</b>	<b>113</b>	645	656	720
FEF25-75 (L/s)	<b>4,48</b>	2,72	<b>4,12</b>	<b>92</b>	4,12	3,88	3,87

Valores en BTSP, \*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

#### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,12 L (1,9%)	0,14 L (2,9%)	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

#### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.

