

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|
| ID: | 10303594 | Grupo de población: | MEJICANO AMERIC | Sexo: | Hombre |
| Apellidos: | HERNANDEZ HERNANDEZ | Nombre: | JOSE | Segundo nombre: | GREGORIO |
| Fecha de nacimiento: | 16/03/1969 | Edad: | 49 | Altura: | 169 cm |
| ID alternativo: | | Peso: | 76,0 kg | IMC: | 26,6 |

Información de la sesión de pruebas

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| Fecha de la prueba: | 05/02/2019 11:10 | Dispositivo: | ALPHA | Número de serie: | 28504 |
| Nº de pruebas: | 5 | Rev. de la exactitud: | 05/02/2019 07:07 | Usuario: | Administrator |
| Valores prev.: | NHANES M | Factor prev.: | 100% | Postura: | Sentado |
| Valores en BTPS | | | | | |

Gráfico de flujo/volumen


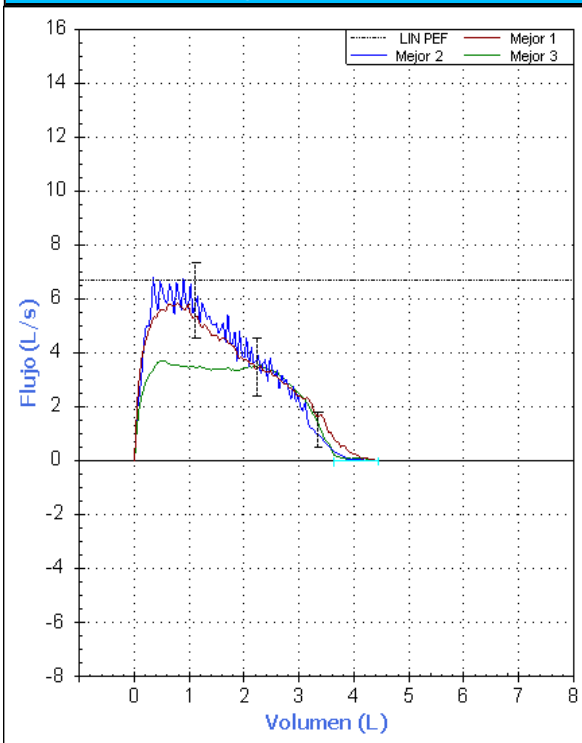


Gráfico de volumen/tiempo

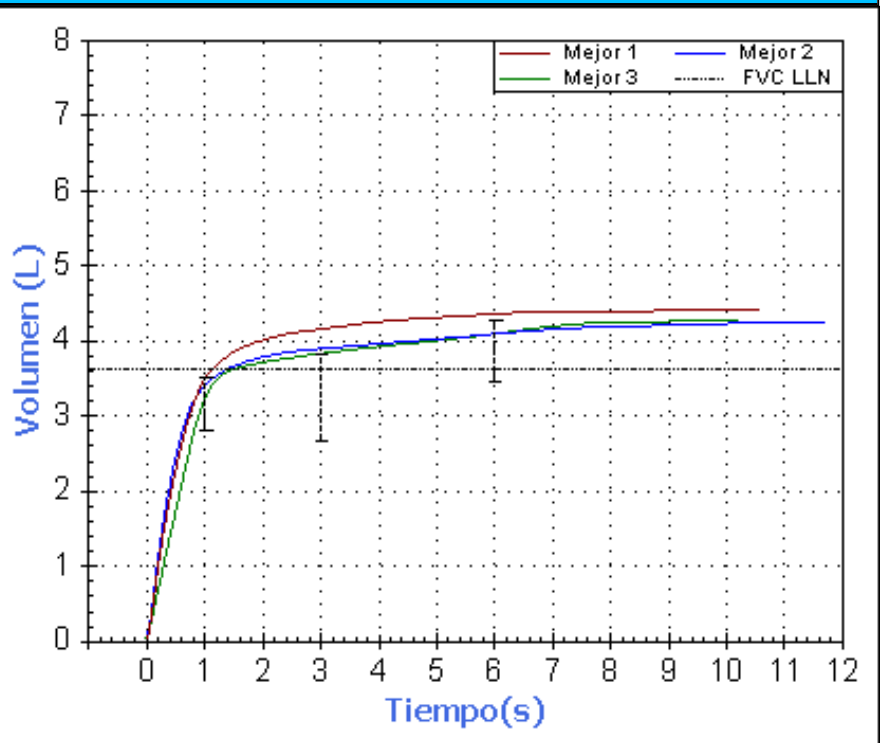

Resultados

| Parámetro | Mejor ATS/ERS | Prev. | Porcentaje prev. | Mejor 1 (Prueba 1) | Mejor 2 (Prueba 3) | Mejor 3 (Prueba 2) |
|------------------|---------------|-------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 11:10:21 | 11:11:52 | 11:11:07 |
| FVC (L) | 4,42 | 4,45 | 99 | 4,42 | 4,26 | 4,28 |
| FEV1 (L) | 3,52 | 3,51 | 100 | 3,52 | 3,40 | 3,25 |
| Relación de FEV1 | 0,80 | 0,79 | 101 | 0,80 | 0,80 | 0,76 |
| PEF (L/Min) | 440 | 545 | 81 | 352* | 440 | 223* |
| FEF25-75 (L/s) | 3,29 | 3,43 | 96 | 3,29 | 3,42 | 3,13 |

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

| Grado de la sesión | Rep. de FVC: | Rep. de FEV1: | Inicio lento de la prueba | No se han cumplido los criterios de finalización de prueba | Tos detectada en 1er segundo |
|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|--|------------------------------|
| A | 0,14 L | 0,12 L | 0 soplo(s) | 0 soplo(s) | 1 soplo(s) |

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____