



Informe de función pulmonar

Información del sujeto



| | | | | | |
|----------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ID: | 47323731 | Grupo de población: | MEJICANO AMERIC | Sexo: | Hombre |
| Apellidos: | OLAYA ATOCHE | Nombre: | JOSE | Segundo nombre: | ERICK JEFFERSON |
| Fecha de nacimiento: | 23/02/1992 | Edad: | 26 | Altura: | 165 cm |
| ID alternativo: | | Peso: | 74,0 kg | IMC: | 27,2 |

Información de la sesión de pruebas

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|
| Fecha de la prueba: | 10/11/2018 11:16 | Dispositivo: | ALPHA | Número de serie: | 28504 |
| Nº de pruebas: | 6 | Rev. de la exactitud: | 13/09/2018 08:05 | Usuario: | Administrator |
| Valores prev.: | NHANES M | Factor prev.: | 100% | Postura: | Sentado |
| Valores en BTPS | | | | | |

Gráfico de flujo/volumen

Gráfico de volumen/tiempo

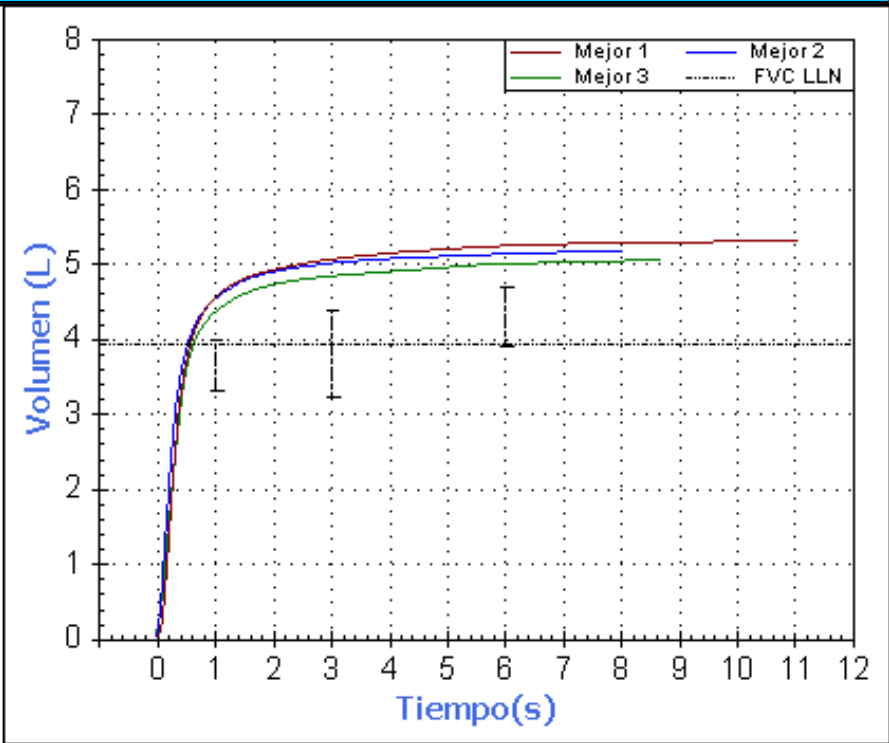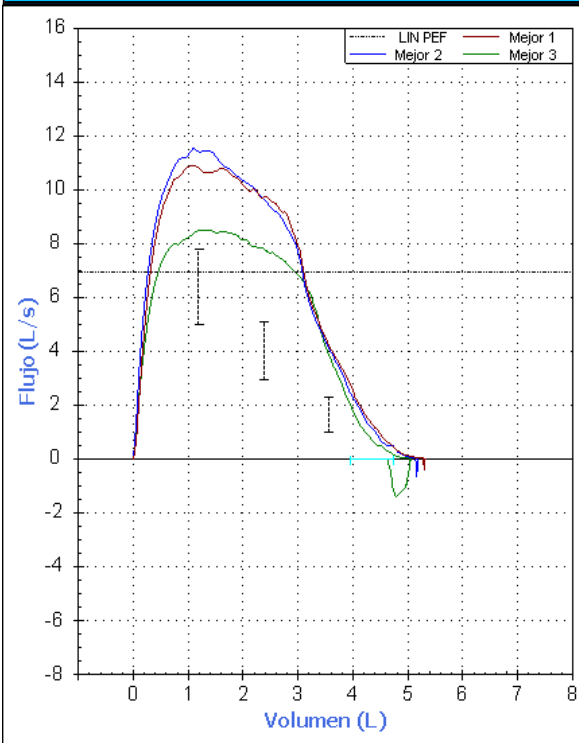

Resultados

| Parámetro | Mejor ATS/ERS | Prev. | Porcentaje prev. | Mejor 1 (Prueba 6) | Mejor 2 (Prueba 5) | Mejor 3 (Prueba 4) |
|------------------|---------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 11:20:21 | 11:19:16 | 11:18:19 |
| FVC (L) | 5,32 | 4,74 | 112 | 5,32 | 5,19 | 5,06 |
| FEV1 (L) | 4,60 | 3,98 | 116 | 4,60 | 4,55 | 4,37 |
| Relación de FEV1 | 0,86 | 0,84 | 102 | 0,86 | 0,88 | 0,86 |
| PEF (L/Min) | 693 | 553 | 125 | 654 | 693 | 512 |
| FEF25-75 (L/s) | 6,58 | 4,39 | 150 | 6,58 | 6,82 | 6,33 |

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

| Grado de la sesión | Rep. de FVC: | Rep. de FEV1: | Inicio lento de la prueba | No se han cumplido los criterios de finalización de prueba | Tos detectada en 1er segundo |
|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|--|------------------------------|
| A | 0,13 L | 0,05 L | 0 soplido(s) | 0 soplido(s) | 0 soplido(s) |

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____